



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.E.29.004.A № 62152

Срок действия бессрочный

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная коммерческого учета потребления/поставки
воды АО "Мосводоканал" (АСКУПВ АО "Мосводоканал")

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 205

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "АКСИТЕХ", г. Москва

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 63817-16

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП 63817-16

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 25 апреля 2016 г. № 467

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С.Голубев

"04" 05 2016 г.

Серия СИ

№ 024552

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная коммерческого учета потребления/поставки воды АО «Мосводоканал» (АСКУПВ АО «Мосводоканал»)

Назначение средства измерений

Система автоматизированная коммерческого учета потребления/поставки воды АО «Мосводоканал» (далее – АСКУПВ), предназначена для измерения давления, объема и расхода холодной и горячей воды, а также автоматического сбора, накопления, обработки, хранения, отображения и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

АСКУПВ представляет собой многоуровневую автоматизированную измерительную систему с централизованным управлением и распределением функций.

АСКУПВ состоит из трех уровней.

Нижний уровень включает в себя:

- теплосчетчики ВИС.Т (рег. № 20064-10), SA-94/3 (рег. № 43231-14) в комплекте с предусмотренной на них технической документацией, датчиками температуры, давления и расхода теплоносителя;

- счетчики холодной воды с импульсным датчиком типа «геркон»: СКБ-40 (рег. № 26343-08), СКБи-40 (рег. № 26343-08), ВСКМ-90 (рег. № 32539-11), ВХ-50/65/80/100 (рег. № 38999-08), ВМХ 50/65/150/200 (рег. № 18312-03), MeiTwin-50 (рег. № 13919-07), MeiStream-100 (рег. № 35547-07), Groen серии WRC(i)-25 (рег. № 51333-12), ВСХН-80 (рег. № 40606-09), ВСХНд-25/40 (рег. № 55115-13), ОСБу-32 (рег. № 32538-11), СТВХ-65 (рег. № 32540-11), МТК-І-40 (рег. № 48242-11); ВСХд- 25/40 (рег. № 40607-09);

- датчики давления МИДА-15 (рег. № 50730-12), преобразователи давления измерительные СДВ (рег. № 28313-11);

- линии передачи электрического сигнала с выхода первичного преобразователя до входов контроллера.

Средний уровень включает в себя модуль процессорный КАМ200-10, модуль дискретных входов КАМ200-50, модуль измерения давления КАМ200-60 контроллера автономного модульного КАМ200 (рег. № 50807-12), с помощью которых реализованы каналы передачи данных (GPRS-каналы, GSM, в том числе коммутаторы, модемы, проводные линии связи (RS-232, RS-485). Передача информации вводится с заданной периодичностью, а также может осуществляться по запросу сервера сбора данных.

Верхний уровень – уровень сбора, хранения и анализа информации, представляет собой оперативно-информационный комплекс – сервер сбора, передачи, архивирования данных и АРМ оператора. Аппаратные средства верхнего уровня включают в себя стандартные IBM-PC-совместимые ПК с установленным ПО, коммуникационное оборудование сетей Ethernet, оборудование проводного и беспроводного доступа к нижнему уровню системы (модемы, радиопередатчики различных частотных диапазонов).

АСКУПВ включает в себя следующие измерительные комплексы, состоящие из компонентов нижнего и среднего уровней, описанных выше:

- «ИК-Колодец»;
- «ИК-ЦТП»;
- «ИК-ДОМ».

Измерительный комплекс устанавливается на каждом объекте мониторинга и состоит из шкафа телеметрии и средств измерений нижнего уровня. На входы расположенного в шкафу телеметрии контроллера автономного модульного КАМ200 поступает информация от аналоговых и дискретных первичных преобразователей (датчиков), а также от измерительных устройств, подключенных по интерфейсам RS-232 и RS-485 (рисунок 1).

(датчиков), а также от измерительных устройств, подключенных по интерфейсам RS-232 и RS-485 (рисунок 1).



Рисунок 1 – Измерительный комплекс АСКУПВ

Полученные данные отправляются на сервер сбора информации, затем могут использоваться внешними сервисами (SCADA-системы, отчетные системы, биллинговые сервисы и т.д.).

Структурная схема АСКУПВ приведена на рисунке 2.

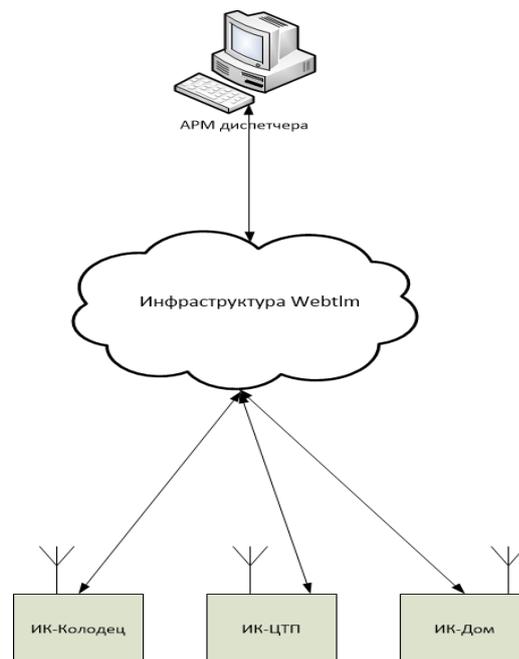


Рисунок 2 – Структурная схема АСКУПВ

АСКУПВ решает следующие задачи:

- периодический (1 раз в сутки) и/или по запросу автоматический сбор и передаче привязанных к единому календарному времени результатов измерений с заданной дискретностью учета (30 минут);

- интеграцию различных систем в единое информационное пространство;
- обработку и подготовку данных для систем коммерческого учета потребления/поставки воды конечному потребителю;
- организацию контроля потерь (несанкционированное использование и утечки);
- организацию электронного инвентарного учета оборудования водомерного узла (далее ВУ) и отдельных компонентов;
- организацию потока данных в сторонние системы для последующей обработки и анализа информации.
- диагностику и мониторинг функционирования технических и программных средств АСКУПВ;
- конфигурирование и настройку параметров АСКУПВ.

Для защиты системы от несанкционированных изменений (корректировок) предусмотрена аппаратная блокировка, пломбирование средств учета, кроссовых и клеммных коробок, использование запираемых шкафов, содержащих средства связи.

Программное обеспечение

Программное обеспечение АСКУПВ состоит из встроенного метрологически значимого ПО измерительных компонентов нижнего уровня системы, внесенных в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Уровень защиты программного обеспечения АСКУПВ (далее - ПО «АСКУПВ») «высокий» (в соответствии с Р 50.2.077-2014) и имеет несколько степеней защиты:

- защита средствами ОС и встроенного ПО: для пользователей присвоен индивидуальный пароль (средства авторизации) и ограничения по выполнению вида операций, блокировки элементов меню управления, средства аутентификации пользователей и разграничение прав доступа к данным, выполнение протоколирования и аудита действий пользователей.

- аппаратная защита – средства аппаратной сигнализации доступа к оборудованию.

ПО «АСКУПВ» и база данных вместе с настройками, журналами событий размещена на отдельном физическом сервере, хранится в центрах обработки данных, которые наиболее полно соответствуют концепциям отказоустойчивости компьютерного оборудования, в котором используется кластеризация ЦПУ, массивы RAID DASH, особые требования к источникам бесперебойного питания и резервированные каналы передачи данных, обеспечивающие высокую надежность, эксплуатационную готовность и ремонтпригодность.

Все метрологически значимые вычисления выполняются ПО измерительных компонентов системы, метрологические характеристики которых нормированы с учетом влияния на них встроенного ПО.

Идентификационные данные ПО «АСКУПВ» приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО «АСКУПВ»

| Идентификационные данные (признаки) | Сервер OPCUA обработки данных для учета потребления воды | ПО контроллера автономного модульного КАМ200 |
|--|--|--|
| Идентификационное наименование ПО | Axitech.AxiUaServer | КАМ200_10S_MVK-1.3.5 |
| Номер версии ПО | 3.11.4.3 | 1.3.5 |
| Цифровой идентификатор ПО | 7bd4926e312b10fb3335bdc32f0b9668 | 76900A82 |
| Алгоритм вычисления цифрового идентификатора | MD5 | CRC32 |

Метрологические и технические характеристики

Состав измерительных каналов АСКУПВ и их основные метрологические характеристики приведены в таблице 2.

Рабочие условия применения компонентов АСКУПВ:

1 Для первичных измерительных преобразователей условия применения определяются их технической документацией;

2 Для модулей процессорных контроллеров автономных модульных КАМ200:

- температура окружающего воздуха: от минус 40 до плюс 50 °С;
- относительная влажность до 80 % при 25 °С без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа;
- напряжение питания от сети переменного тока напряжением от 3,4 до 4,2 В.

3 Для АРМ оператора:

- температура окружающего воздуха: плюс 10 до плюс 35 °С;
- относительная влажность от 30 до 80 %;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа;
- напряжение питания от сети переменного тока напряжением от 187 до 242 В
- частота (50±1) Гц.

Таблица 2 – Состав измерительных каналов АСКУПВ и их основные метрологические характеристики

| Наименование ИК, адрес объекта | Номер ввода | Состав ИК | | | Диапазон измерений ИК | Q _t , пере- ходный расход | Пределы допускаемой основной погрешности счетчика (датчика) | Преде- лы допус- каемой основ- ной погреш- ности ИК |
|--|------------------|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|
| | | Тип первичного измерительного преобразователя | Тип промежуточного измерительного пре- образователя | Модуль сбора и пе- редачи данных | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «ИК-ЦТП», г. Москва, Таллинская ул., д. 5 к.3 | 37010, 37010,001 | Счетчик холодной воды турбинный MeiStream-100 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,3 до 240,0 м ³ /ч | 0,6 м ³ /ч | $\delta = \pm 5 \%$ от Q _{min} до Q _t | см. приме- чание 2 |
| | | Счетчик холодной воды ВХ-100 | | | от 0,3 до 240,0 м ³ /ч | | | |
| | | Преобразователь избыточного дав- ления измеритель- ный СДВ-И | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2 \%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | – | $\gamma = \pm 0,5 \%$ от ДИ | |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|------------------|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|----------------------------|
| «ИК-ЦТП», г. Москва, Таллинская ул., д. 19 | 37005, 37005,001 | Счетчик холодной воды турбинный MeiStream-100 | Модуль дискретных выходов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,3 до 240,0 м ³ /ч | 0,6 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Счетчик холодной воды турбинный ВХ-80 | | | от 0,5 до 200,0 м ³ /ч | 0,5 м ³ /ч | | |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | – | $\gamma = \pm 0,5\%$ от ДИ | $\gamma = \pm 0,7\%$ от ДИ |
| «ИК-ЦТП», г. Москва, Кулакова ул., д. 21 | 33645, 33645,001 | Счетчик холодной воды турбинный MeiStream-100 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,3 до 240,0 м ³ /ч | 0,6 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Счетчик холодной воды крыльчатый СТВХ-65 | | | от 0,45 до 120, м ³ /ч | 1,2 м ³ /ч | | |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | – | $\gamma = \pm 0,5\%$ от ДИ | $\gamma = \pm 0,7\%$ от ДИ |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|------------------|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
| «ИК-ЦТП», г. Москва, Строгинский бульв., д. 26 к.2 стр. 2 | 37007, 37007,001 | Счетчик холодной воды турбинный ВХ-100 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,3 до 240,0 м ³ /ч | 0,6 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ СВЫШЕ Q_t до Q_{\max} | см. при- мечание 2 |
| | | Счетчик холодной воды турбинный ВСХН-80 | | | от 0,5 до 200,0 м ³ /ч | 0,8 м ³ /ч | | |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | – | $\gamma = \pm 0,5\%$ от ДИ | $\gamma = \pm 0,7\%$ от ДИ |
| «ИК-ЦТП», г. Москва, Строгинский бульв., д. 14 к.2 стр. 2 | 36853, 36853,001 | Счетчик холодной воды турбинный ВХ-100 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,3 до 240,0 м ³ /ч | 0,6 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ СВЫШЕ Q_t до Q_{\max} | см. при- мечание 2 |
| | | Счетчик холодной воды турбинный ВХ-80 | | | от 0,3 до 150,0 м ³ /ч | 0,5 м ³ /ч | | |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | – | $\gamma = \pm 0,5\%$ от ДИ | $\gamma = \pm 0,7\%$ от ДИ |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|------------------|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|----------------------------|
| «ИК-ЦТП», г. Москва, Таллинская ул., д. 9 | 36928, 36928,001 | Счетчик холодной воды турбинный ВМХ-150 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 2,0 до 500,0 м ³ /ч | 4,0 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Счетчик холодной воды турбинный ВХ-100 | | | от 0,3 до 240,0 м ³ /ч | 0,6 м ³ /ч | | |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | – | $\gamma = \pm 0,5\%$ от ДИ | $\gamma = \pm 0,7\%$ от ДИ |
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Таллинская ул., д. 3 стр. 2 | 37010,008 | Счетчик холодной воды крыльчатый МТК-І-40 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | см. таб. 3 | см. таб. 3 | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | – | | |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-----------|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|------------------|
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Таллинская ул., д. 7 | 37010,009 | Счетчик холодной воды крыльчатый ВСХд-40 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,20 до 20,0 м ³ /ч | 0,80 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 3\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | | | | |
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Кулакова ул., д. 25 к.3 | 37010,010 | Счетчик холодной воды крыльчатый ВСХНд-40 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,16 до 20,0 м ³ /ч | 0,26 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 3\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | | | | |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-----------|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|------------------|
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Строгинский бульв., д. 14 к.6 | 36853,006 | Счетчик холодной воды крыльчатый МТК-1-40 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | см. таб. 3 | см. таб. 3 | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | | | от 0 до 1,0 МПа | – |
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Строгинский бульв., д. 14 к.7 | 36853,010 | Счетчик холодной воды крыльчатый ВСХНд-25 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,063 до 7,0 м ³ /ч | 0,1 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Преобразователь избыточного давления измерительный СДВ-И | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | | | от 0 до 1,0 МПа | – |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-----------|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|----------------------------|
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Таллинская ул., д. 13 к.1 | 36928,014 | Счетчик холодной воды тахометрический Groen серии WRC(i)-25 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,07 до 7,0 м ³ /ч | 0,28 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | – | $\gamma = \pm 0,5\%$ от ДИ | $\gamma = \pm 0,7\%$ от ДИ |
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Таллинская ул., д. 17 к.1 | 37005,007 | Счетчик холодной воды крыльчатый ВСХН-25 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,063 до 7,0 м ³ /ч | 0,1 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | – | $\gamma = \pm 0,5\%$ от ДИ | $\gamma = \pm 0,7\%$ от ДИ |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-----------|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|----------------------------|
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Таллинская ул., д. 3 к.1 | 37010,004 | Счетчик холодной воды турбинный ВХ-65 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,24 до 70,0 м ³ /ч | 0,36 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Преобразователь избыточного давления измерительный СДВ-И | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | – | $\gamma = \pm 0,5\%$ от | $\gamma = \pm 0,7\%$ от ДИ |
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Таллинская ул., д. 5 к.3 | 37010,007 | Счетчик холодной воды турбинный ВМХ-50 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,3 до 120,0 м ³ /ч | 0,9 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Преобразователь избыточного давления измерительный СДВ-И | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | – | $\gamma = \pm 0,5\%$ от ДИ | $\gamma = \pm 0,7\%$ от ДИ |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-----------|--|--|-------------------------------|---|-----------------------|---|----------------------------|
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Таллинская ул., д. 5 к.4 | 37010,006 | Счетчик холодной воды турбинный ВМХ-50 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,3 до 120,0 м ³ /ч | 0,9 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Теплосчетчик ВИС.Т | — | | Температура измеряемой среды от 0 до +150 °С. Разность температур в подающем и обратном трубопроводах. от +1 до +149 °С. Абсолютное давление измеряемой среды от 0,01 до 2,5 МПа. Диапазон условных внутренних диаметров Ду первичных преобразователей расхода полнопроходного исполнения . от 2,5 до 800 мм. Средняя скорость потока теплоносителя от 1,0 до 10 м/с. | — | Измерения объемного расхода (см. таб. 4) | см. примечание 2 |
| | | Преобразователь избыточного давления измерительный СДВ-И | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | — | $\gamma = \pm 0,5\%$ от ДИ | $\gamma = \pm 0,7\%$ от ДИ |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-----------|--|--|-------------------------------|---|-----------------------|---|----------------------------|
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Таллинская ул., д. 5 к.2 | 37010,005 | Счетчик холодной воды турбинный ВМХ-50 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,3 до 120,0 м ³ /ч | 0,9 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Теплосчетчик ВИС.Т | – | | Температура измеряемой среды от 0 до +150 °С. Разность температур в подающем и обратном трубопроводах. от +1 до +149 °С. Абсолютное давление измеряемой среды от 0,01 до 2,5 МПа. Диапазон условных внутренних диаметров D_u первичных преобразователей расхода полнопроходного исполнения. от 2,5 до 800 мм. Средняя скорость потока теплоносителя от 1,0 до 10 м/с. | – | Измерения объемного расхода (см. таб. 4) | см. примечание 2 |
| | | Преобразователь избыточного давления измерительный СДВ-И | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | – | $\gamma = \pm 0,5\%$ от ДИ | $\gamma = \pm 0,7\%$ от ДИ |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-----------|--|--|-------------------------------|---|------------------------|---|----------------------------|
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Кулакова ул., д. 25 к.1 | 37010,002 | Счетчик холодной воды турбинный ВХ-65 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,24 до 70,0 м ³ /ч | 0,36 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Преобразователь избыточного давления измерительный СДВ-И | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | – | $\gamma = \pm 0,5\%$ от ДИ | $\gamma = \pm 0,7\%$ от ДИ |
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Кулакова ул., д. 27 | 37010,003 | Счетчик холодной воды турбинный ВМХ-50 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,3 до 120,0 м ³ /ч | 0,9 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Теплосчетчик ВИС.Т | – | | Температура измеряемой среды от 0 до +150 °С. Разность температур в подающем и обратном трубопроводах. от +1 до +149 °С. Абсолютное давление измеряемой среды от 0,01 до 2,5 МПа. Диапазон условных внутренних диаметров Ду первичных преобразователей расхода полнопроходного исполнения . от 2,5 до 800 мм. Средняя скорость потока теплоносителя от 1,0 до 10 м/с. | – | Измерения объемного расхода (см. таб. 4) | см. примечание 2 |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | – | $\gamma = \pm 0,5\%$ от ДИ | $\gamma = \pm 0,7\%$ от ДИ |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------------|---|------------------------|---|----------------------------|
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Таллинская ул., д. 17 к.3 | 37005,004 | Счетчик холодной воды турбинный ВХ-65 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,24 до 70,0 м ³ /ч | 0,36 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Теплосчетчик ВИС.Т | — | | Температура измеряемой среды от 0 до +150 °С. Разность температур в подающем и обратном трубопроводах. от +1 до +149 °С. Абсолютное давление измеряемой среды от 0,01 до 2,5 МПа. Диапазон условных внутренних диаметров Ду первичных преобразователей расхода полнопроходного исполнения . от 2,5 до 800 мм. Средняя скорость потока теплоносителя от 1,0 до 10 м/с. | — | Измерения объемного расхода (см. таб. 4) | см. примечание 2 |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | — | $\gamma = \pm 0,5\%$ от ДИ | $\gamma = \pm 0,7\%$ от ДИ |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-----------|--|--|-------------------------------|---|-----------------------|---|----------------------------|
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Таллинская ул., д. 17 к.2 | 37005,005 | Счетчик холодной воды турбинный ВМХ-50 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,3 до 120,0 м ³ /ч | 0,9 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Теплосчетчик ВИС.Т | — | | Температура измеряемой среды от 0 до +150 °С. Разность температур в подающем и обратном трубопроводах. от +1 до +149 °С. Абсолютное давление измеряемой среды от 0,01 до 2,5 МПа. Диапазон условных внутренних диаметров Ду первичных преобразователей расхода полнопроходного исполнения . от 2,5 до 800 мм. Средняя скорость потока теплоносителя от 1,0 до 10 м/с. | — | Измерения объемного расхода (см. таб. 4) | см. примечание 2 |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | — | $\gamma = \pm 0,5\%$ от ДИ | $\gamma = \pm 0,7\%$ от ДИ |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-----------|--|--|-------------------------------|--|-----------------------|---|----------------------------|
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Таллинская ул., д. 17 к.4 | 37005,002 | Счетчик холодной воды турбинный ВМХ-50 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,3 до 120,0 м ³ /ч | 0,9 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Теплосчетчик SA-94/3 | — | | Температура измеряемой среды от +20 до +150 °С. Разность температур в подающем и обратном трубопроводах от +5 до +140 °С. Абсолютное давление измеряемой среды от 0,4 до 4,0 МПа. Диапазон условных внутренних диаметров Ду первичных преобразователей расхода полнопроходного исполнения от 10 до 400 мм. Средняя скорость потока теплоносителя от 1,6 до 10 м/с. Значения верхнего предела измерения расхода теплоносителя в трубопроводе определяются используемыми измерительными преобразователями расхода и приведены в таблице 5. | — | Измерения объемного расхода (см. таб. 5) | см. примечание 2 |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | — | $\gamma = \pm 0,5\%$ от ДИ | $\gamma = \pm 0,7\%$ от ДИ |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-----------|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|------------------------------------|
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Таллинская ул., д. 19 к.1 | 37005,003 | Счетчик холодной воды турбинный ВХ-65 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,24 до 70,0 м ³ /ч | 0,36 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. при- мечание 2 |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | – | $\gamma = \pm 0,5\%$ от ДИ | $\gamma =$ $\pm 0,7\%$ от ДИ |
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Таллинская ул., д. 19 к.2 | 37005,006 | Счетчик холодной воды крыльчатый МТК-I-40 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | см. таб. 3 | см. таб. 3 | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. при- мечание 2 |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | – | $\gamma = \pm 0,5\%$ от ДИ | $\gamma =$ $\pm 0,7\%$ от ДИ |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------|---|----------------------------|
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Строгинский бульв., д. 4 к.1 | 33645,004 | Счетчик холодной воды турбинный ВХ-65 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,24 до 70,0 м ³ /ч | 0,36 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Теплосчетчик ВИС.Т | — | | Температура измеряемой среды от 0 до +150 °С. Разность температур в подающем и обратном трубопроводах. от +1 до +149 °С. Абсолютное давление измеряемой среды от 0,01 до 2,5 МПа. Диапазон условных внутренних диаметров D_u первичных преобразователей расхода полнопроходного исполнения . от 2,5 до 800 мм. Средняя скорость потока теплоносителя от 1,0 до 10 м/с. | — | Измерения объемного расхода (см. таб. 4) | см. примечание 2 |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | — | $\gamma = \pm 0,5\%$ от ДИ | $\gamma = \pm 0,7\%$ от ДИ |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-----------|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|----------------------------|
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Строгинский бульв., д. 4 к.2 | 33645,002 | Счетчик холодной воды турбинный ВХ-50 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,2 до 50,0 м ³ /ч | 0,32 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | – | $\gamma = \pm 0,5\%$ от ДИ | $\gamma = \pm 0,7\%$ от ДИ |
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Кулакова ул., д. 21 | 33645,003 | Счетчик холодной воды турбинный ВМХ-50 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,3 до 120,0 м ³ /ч | 0,9 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | – | $\gamma = \pm 0,5\%$ от ДИ | $\gamma = \pm 0,7\%$ от ДИ |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-----------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|------------------------------------|
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Кулакова ул., д. 23 | 33645,005 | Счетчик холодной воды крыльчатый СКБ-40 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,2 до 20,0 м ³ /ч | 0,8 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. при- мечание 2 |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | – | $\gamma = \pm 0,5\%$ от ДИ | $\gamma =$ $\pm 0,7\%$ от ДИ |
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Кулакова ул., д. 25 к.2 | 33645,006 | Счетчик холодной воды крыльчатый СКБи-40 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,2 до 20,0 м ³ /ч | 0,4 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. при- мечание 2 |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | – | $\gamma = \pm 0,5\%$ от ДИ | $\gamma =$ $\pm 0,7\%$ от ДИ |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------------|---|------------------------|---|----------------------------|
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Строгинский бульв., д. 26 к.1 | 37007,003 | Счетчик холодной воды турбинный ВХ-50 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,2 до 50,0 м ³ /ч | 0,32 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | – | $\gamma = \pm 0,5\%$ от ДИ | $\gamma = \pm 0,7\%$ от ДИ |
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Строгинский бульв., д. 26 к.2 | 37007,004 | Счетчик холодной воды турбинный ВХ-65 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,24 до 70,0 м ³ /ч | 0,36 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Теплосчетчик ВИС.Т | – | | Температура измеряемой среды от 0 до +150 °С. Разность температур в подающем и обратном трубопроводах. от +1 до +149 °С. Абсолютное давление измеряемой среды от 0,01 до 2,5 МПа. Диапазон условных внутренних диаметров D_u первичных преобразователей расхода полнопроходного исполнения от 2,5 до 800 мм. Средняя скорость потока теплоносителя от 1,0 до 10 м/с | – | Измерения объемного расхода (см. таб. 4) | см. примечание 2 |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | – | $\gamma = \pm 0,5\%$ от ДИ | $\gamma = \pm 0,7\%$ от ДИ |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-----------|--|--|-------------------------------|---|-----------------------|---|----------------------------|
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Строгинский бульв., д. 26 к.2 | 37007,005 | Счетчик холодной воды турбинный ВМХ-65 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,45 до 180,0 м ³ /ч | 1,0 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Теплосчетчик ВИС.Т | — | | Температура измеряемой среды от 0 до +150 °С. Разность температур в подающем и обратном трубопроводах. от +1 до +149 °С. Абсолютное давление измеряемой среды от 0,01 до 2,5 МПа. Диапазон условных внутренних диаметров Ду первичных преобразователей расхода полнопроходного исполнения . от 2,5 до 800 мм. Средняя скорость потока теплоносителя от 1,0 до 10 м/с. | — | Измерения объемного расхода (см. таб. 4) | см. примечание 2 |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | — | $\gamma = \pm 0,5\%$ от ДИ | $\gamma = \pm 0,7\%$ от ДИ |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-----------|--|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|--------------------------|
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Строгинский бульв., д. 26 к.3 | 37007,002 | Счетчик холодной воды турбинный ВХ-50 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,2 до 50,0 м ³ /ч | 0,32 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. приме- чание 2 |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | | | | |
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Строгинский бульв., д. 10 к.3 | 11268 | Счетчик холодной воды крыльчатый ОСВУ-32 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,12 до 12,0 м ³ /ч | 0,48 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 3\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. приме- чание 2 |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | | | | |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-----------|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|------------------|
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Строгинский бульв., д. 14 к.1 | 36853,003 | Счетчик холодной воды турбинный ВМХ-50 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,3 до 120,0 м ³ /ч | 0,9 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | | | | |
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Строгинский бульв., д. 14 к.2 | 36853,004 | Счетчик холодной воды турбинный ВХ-50 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,2 до 50,0 м ³ /ч | 0,32 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | | | | |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------|---|----------------------------|
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Строгинский бульв., д. 14 к.3 | 36853,005 | Счетчик холодной воды турбинный ВХ-65 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,24 до 70,0 м ³ /ч | 0,36 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Теплосчетчик ВИС.Т | — | | Температура измеряемой среды от 0 до +150 °С. Разность температур в подающем и обратном трубопроводах. от +1 до +149 °С. Абсолютное давление измеряемой среды от 0,01 до 2,5 МПа. Диапазон условных внутренних диаметров D_u первичных преобразователей расхода полнопроходного исполнения . от 2,5 до 800 мм. Средняя скорость потока теплоносителя от 1,0 до 10 м/с. | | Измерения объемного расхода (см. таб. 4) | см. примечание 2 |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | — | $\gamma = \pm 0,5\%$ от ДИ | $\gamma = \pm 0,7\%$ от ДИ |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------------|--|--|---|----------------------------|
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Строгинский бульв., д. 14 к.4 | 36853,002 | Счетчик холодной воды турбинный ВХ-50 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,2 до 50,0 м ³ /ч | 0,32 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Теплосчетчик SA-94/3 | — | | Температура измеряемой среды от +20 до +150 °С. Разность температур в подающем и обратном трубопроводах от +5 до +140 °С. Абсолютное давление измеряемой среды от 0,4 до 4,0 МПа. Диапазон условных внутренних диаметров Ду первичных преобразователей расхода полнопроходного исполнения от 10 до 400 мм. Средняя скорость потока теплоносителя от 1,6 до 10 м/с. Значения верхнего предела измерения расхода теплоносителя в трубопроводе определяются используемыми измерительными преобразователями расхода и приведены в таблице 5. | Измерения объемного расхода (см. таб. 5) | см. примечание 2 | |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | — | $\gamma = \pm 0,5\%$ от ДИ | $\gamma = \pm 0,7\%$ от ДИ |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-----------|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|----------------------------|
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Строгинский бульв., д. 14 к.5 | 36928,007 | Счетчик холодной воды крыльчатый ВСКМ-90 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | 0,4 - 20 м ³ /ч | 1 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ СВЫШЕ Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | | | | |
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Строгинский бульв., д. 26 к.4 | 13971 | Счетчик холодной воды крыльчатый ОСВУ-32 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,12 до 12,0 м ³ /ч | 0,48 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 3\%$ СВЫШЕ Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Счетчик холодной воды турбинный ВХ-50 | | | | | | |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | – | $\gamma = \pm 0,5\%$ от ДИ | $\gamma = \pm 0,7\%$ от ДИ |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-----------|--|--|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|---|----------------------------|
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Таллинская ул., д. 9 к.3 | 36928,004 | Счетчик холодной воды турбинный ВХ-50 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,2 до 50,0 м ³ /ч | 0,32 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Преобразователь избыточного давления измерительный СДВ-И | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | – | $\gamma = \pm 0,5\%$ от ДИ | $\gamma = \pm 0,7\%$ от ДИ |
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Таллинская ул., д. 9 к.2 | 36928,007 | Счетчик холодной воды турбинный ВХ-50 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,2 до 50,0 м ³ /ч | 0,32 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | – | $\gamma = \pm 0,5\%$ от ДИ | $\gamma = \pm 0,7\%$ от ДИ |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-----------|--|--|-------------------------------|--|------------------------|---|----------------------------|
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Таллинская ул., д. 9 к.4 | 36928,008 | Счетчик холодной воды турбинный ВМХ-50 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,3 до 120,0 м ³ /ч | 0,9 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Теплосчетчик ВИС.Т | — | | Температура измеряемой среды от 0 до +150 °С. Разность температур в подающем и обратном трубопроводах. от +1 до +149 °С. Абсолютное давление измеряемой среды от 0,01 до 2,5 МПа. Диапазон условных внутренних диаметров D_u первичных преобразователей расхода полнопроходного исполнения . от 2,5 до 800 мм. Средняя скорость потока теплоносителя от 1,0 до 10 м/с. | — | Измерения объемного расхода (см. таб. 4) | см. примечание 2 |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | — | $\gamma = \pm 0,5\%$ от ДИ | $\gamma = \pm 0,7\%$ от ДИ |
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Таллинская ул., д. 11 | 36928,006 | Счетчик холодной воды турбинный ВХ-65 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,24 до 70,0 м ³ /ч | 0,36 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | — | $\gamma = \pm 0,5\%$ от ДИ | $\gamma = \pm 0,7\%$ от ДИ |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-----------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|---|------------------------------------|
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Таллинская ул., д. 11 к.2 | 36928,009 | Счетчик холодной воды крыльчатый СКБи-40 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,2 до 20,0 м ³ /ч | 0,4 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. при- мечание 2 |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | – | $\gamma = \pm 0,5\%$ от ДИ | $\gamma =$ $\pm 0,7\%$ от ДИ |
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Таллинская ул., д. 13 к.2 | 36928,002 | Счетчик холодной воды турбинный ВХ-50 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,2 до 50,0 м ³ /ч | 0,32 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. при- мечание 2 |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | – | $\gamma = \pm 0,5\%$ от ДИ | $\gamma =$ $\pm 0,7\%$ от ДИ |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-----------|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|------------------|
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Таллинская ул., д. 13 к.3 | 36928,005 | Счетчик холодной воды комбинированный MeiTwin-50 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,05 до 90,0 м ³ /ч | 0,2 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ СВЫШЕ Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | | | | |
| «ИК-ДОМ», г. Москва, Таллинская ул., д. 13 к.4 | 36928,003 | Счетчик холодной воды турбинный ВМХ-50 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 0,3 до 120,0 м ³ /ч | 0,9 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ СВЫШЕ Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Датчик давления МИДА-ДИ-15 | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | | | | |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-------|--|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|------------------|
| «ИК-Колодец» г. Москва, Кулакова ул., (возле д. 27), между колодцами 78701 и 78702 | 78102 | Счетчик холодной воды турбинный ВМХ-200 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 4,0 до 1000 м ³ /ч | 6,0 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Преобразователь гидростатического давления измерительный СДВ-Г | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | | | от 0 до 1,0 МПа | - |
| «ИК-Колодец» г. Москва, Таллинская ул., (возле д. 3 к.1), между колодцами 78237 и 78238 | 78238 | Счетчик холодной воды турбинный ВМХ-200 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 4,0 до 1000 м ³ /ч | 6,0 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Преобразователь гидростатического давления измерительный СДВ-Г | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | | | от 0 до 1,0 МПа | - |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-------|--|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------|
| «ИК-Колодец», г. Москва, Кулакова ул., (возле д. 21 и д. 23), между колодцами 78053 и 78703 | 78703 | Счетчик холодной воды турбинный ВМХ-200 | Модуль дискретных входов КАМ200-50 ($\delta = \pm 1$ импульс на 1000 импульсов) | Модуль процессорный КАМ200-10 | от 4,0 до 1000 м ³ /ч | 6,0 м ³ /ч | $\delta = \pm 5\%$ от Q_{\min} до Q_t $\delta = \pm 2\%$ свыше Q_t до Q_{\max} | см. примечание 2 |
| | | Преобразователь гидростатического давления измерительный СДВ-Г | Модуль измерения давления КАМ200-60 ($\gamma = \pm 0,2\%$ от ДИ) | | от 0 до 1,0 МПа | – | $\gamma = \pm 0,5\%$ от ДИ | $\gamma = \pm 0,7\%$ от ДИ |

Примечания

- 1 ВИК – вторичная (электрическая) часть ИК,
 δ – относительная погрешность, %,
 γ – приведенная погрешность, %,
 ДИ – диапазон измерений.

$$2 \delta_{\text{ИК объемного расхода, объема воды}} = \pm \left(\delta_{\text{дат}} + \frac{(Q_{\text{max}} - Q_{\text{min}})}{Q_i} \cdot \gamma_{\text{ВИК}} \right) \quad (1)$$

где $\delta_{\text{дат}}$ - пределы допускаемой основной относительной погрешности первичного измерительного преобразователя (датчика) %;

Q_{max} – максимальное значение диапазона измерений объемного расхода (объема) воды, м³/ч;

Q_{min} – минимальное значение диапазона измерений объемного расхода (объема) воды, м³/ч;

$\gamma_{\text{ВИК}}$ – пределы допускаемой основной приведенной погрешности ВИК, %;

Q_i – измеренное значение объема, м³/ч.

- 3 Для расчёта погрешности ИК в рабочих условиях применения:

- приводят форму представления основных и дополнительных погрешностей измерительных компонентов к единому виду (приведенная, относительная, абсолютная, к входу или выходу ИК);

- для каждого измерительного компонента из состава ИК рассчитывают пределы допускаемой погрешности в фактических условиях путем учета основной и дополнительных погрешностей от влияющих факторов на момент расчёта.

Пределы допускаемой погрешности Δ_{cu} измерительного компонента в фактических условиях применения вычисляют по формуле:

$$\Delta_{cu} = \Delta_o + \sum_{i=1..n} \Delta_i, \quad (2)$$

где Δ_o - пределы допускаемой основной погрешности измерительного компонента;

Δ_i - пределы допускаемой дополнительной погрешности измерительного компонента от i -го влияющего фактора в фактических условиях применения при общем числе n учитываемых влияющих факторов.

Пределы допускаемой погрешности ИК в фактических условиях применения вычисляют по формуле:

$$\Delta_{\text{ИК}} = \Delta_{cu1} + \Delta_{cu2}, \quad (3)$$

где $\Delta_{\text{ИК}}$ - пределы допускаемой погрешности ИК;

Δ_{cu1} - пределы допускаемой погрешности первичного измерительного преобразователя, рассчитывается по формуле 2;

Δ_{cu2} - пределы допускаемой погрешности ВИК, рассчитываются по формуле 2.

Таблица 3 – Метрологические характеристики счетчиков воды М (исполнение МТК).

| | | |
|--|-----|------|
| Диаметр условного прохода трубы, мм | 40 | |
| Метрологический класс | В | |
| Номинальный расход Q_n , м ³ /ч | 10 | 15 |
| Максимальный расход Q_{max} , м ³ /ч | 20 | 30 |
| Переходный расход Q_t , л ³ /ч | 800 | 2250 |
| Минимальный расход Q_{min} , л ³ /ч | 200 | 450 |

Таблица 4 – Пределы допускаемой относительной погрешности каналов объемного расхода и объема δ , % для теплосчетчиков ВИС.Т

| | Поддиапазон, % верхнего предела измерения расхода | | | |
|--|---|------------|------------|------------|
| | 0,4-1,0 | 1-4 | 4-10 | 10-100 |
| Допускаемая относительная погрешность измерения, % | $\pm 1,85$ | $\pm 1,10$ | $\pm 0,75$ | $\pm 0,60$ |

Таблица 5 – Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объемного расхода (объема) для теплосчетчиков SA-94/3 теплоносителя (воды) в зависимости от первичных средств измерений.

| Счетчики жидкости | Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объемного расхода (объема) теплоносителя (воды), % |
|-------------------------|--|
| ИК с использованием ПРЭ | $\pm 2,0$ |
| VA-2305M | $\pm 1,0$ |
| VA-2304 | $\pm 2,0$ |
| VA-2301 | |
| VA-2302 | |
| ВСТ | |
| ЕТ | $\pm 5,0$ |
| МТ | |
| W | |
| ВМГ | |

Примечание - ПРЭ – преобразователь расхода электромагнитный.

Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульный лист документа АЕТС.425790.001 РЭ «Система автоматизированная коммерческого учета потребления/поставки воды АО «Мосводоканал» (АСКУПВ АО «Мосводоканал»). Руководство по эксплуатации».

Комплектность средства измерений

Комплектность АСКУПВ указана в таблице 6.

Таблица 6. Комплектность АСКУПВ

| Наименование (тип) | Кол-во (шт.) |
|---|--------------|
| 1 Счетчики холодной воды турбинные MeiStream-100 | 3 |
| 2 Счетчики холодной воды турбинные ВСХН-80 | 1 |
| 3 Счетчики холодной воды турбинные ВХ-50 | 9 |
| 4 Счетчики холодной воды турбинные ВХ-65 | 8 |
| 5 Счетчики холодной воды турбинные ВХ-80 | 2 |
| 6 Счетчики холодной воды турбинные ВХ-100 | 4 |
| 7 Счетчики холодной воды комбинированные MeiTwin-50 | 1 |
| 8 Счетчики холодной воды турбинные ВМХ-50 | 10 |
| 9 Счетчики холодной воды турбинные ВМХ-65 | 1 |
| 10 Счетчик холодной воды турбинный ВМХ-150 | 1 |

| Наименование (тип) | Кол-во (шт.) |
|---|--------------|
| 11 Счетчики холодной воды турбинные ВМХ-200 | 3 |
| 12 Счетчики холодной воды крыльчатые СКБ-40 | 1 |
| 13 Счетчик холодной воды крыльчатый СКБи-40 | 2 |
| 14 Счетчик холодной воды тахометрический Groen серии WRC(i)-25 | 1 |
| 15 Счетчики холодной воды крыльчатые ВСХН-25 | 1 |
| 16 Счетчики холодной воды крыльчатые ВСХНд-25 | 1 |
| 17 Счетчик холодной воды крыльчатый ВСХНд-40 | 1 |
| 18 Счетчик холодной воды крыльчатый ВСХд-40 | 1 |
| 19 Счетчик и холодной воды крыльчатые ОСВУ-32 | 2 |
| 20 Счетчики холодной воды крыльчатые МТК-І-40 | 3 |
| 21 Счетчики холодной воды крыльчатые ВСКМ-90 | 1 |
| 22 Счетчик холодной воды турбинный СТВХ-65 | 1 |
| 23 Датчики давления МИДА-ДИ-15 | 40 |
| 24 Преобразователи избыточного давления измерительные СДВ-И | 8 |
| 25 Преобразователи гидростатического давления измерительные СДВ-Г | 3 |
| 26 Теплосчетчики ВИС.Т | 10 |
| 27 Теплосчетчики SA-94/3 | 2 |
| Шкаф телеметрии: | |
| 28 Модули процессорные КАМ200-10 | 51 |
| 29 Модули дискретных входов КАМ200-50 | 51 |
| 30 Модули измерения давления КАМ200-60 | 51 |

В комплект поставки входит техническая документация на АСКУПВ и на комплектующие средства измерений, а также методика поверки «Система автоматизированная коммерческого учета потребления/поставки воды АО «Мосводоканал» (АСКУПВ АО «Мосводоканал»). Методика поверки».

Поверка

осуществляется по документу МП 63817-16 «Система автоматизированная коммерческого учета потребления/поставки воды АО «Мосводоканал» (АСКУПВ АО «Мосводоканал»). Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 24 февраля 2016г.

Основные средства поверки первичных преобразователей указаны в методиках поверки на них.

Основное средство поверки для поверки вторичной части измерительных каналов АСКУПВ:

- калибратор многофункциональный МС5-R рег. № 22237-08.

Знак поверки в виде наклейки наносят на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе АЕТС.425790.001 РЭ «Система автоматизированная коммерческого учета потребления/поставки воды АО «Мосводоканал» (АСКУПВ АО «Мосводоканал»). Руководство по эксплуатации».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной коммерческого учета потребления/поставки воды АО «Мосводоканал» (АСКУПВ АО «Мосводоканал»)

1 ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;

2 ТУ 4257-001-87568835-2014 «Система автоматизированная коммерческого учета потребления/поставки воды АО «Мосводоканал» (АСКУПВ АО «Мосводоканал»). Технические условия».

Изготовитель

ООО «АКСИТЕХ»

Юридический адрес: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 7

ИНН 7715708080

Телефон: (495) 669-05-34

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, Москва, ул. Озерная, 46

Тел./факс: (495) 437 55 77 / 437 56 66

E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии



С.С. Голубев

М.п.

« 04 » 05

2016 г.

С

[Handwritten signature]